


Logo Audioprothésiste

Monsieur Jules D.
Date de naissance: 08/04/1943
Adresse: 12 rue des Peupliers à Wambrechies
Médecin prescripteur: Docteur XX
Médecin généraliste: Docteur XX

Date d'appareillage: 15/09/2021
Audioprothésiste: XX
Appareil droit: Type X - Marque X - N° de série X
Appareil gauche: Type X - Marque X - N° de série X

Audiométrie tonale des 26/08 et 15/09/2021

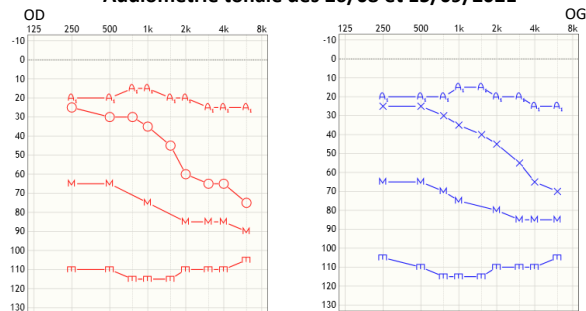


Conditions du test

- Test d'orientation au casque
- Test de contrôle en champ libre
- Signal : Son Vobulé

Recto standard


Audiométrie vocale des 26/08 et 15/09/2021

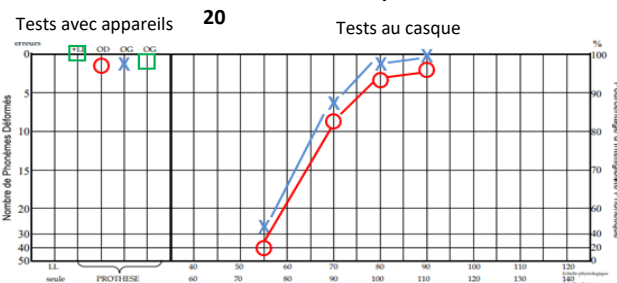

Conditions du test

- Listes cochléaires du test phonétique de LAFON


Audiométrie vocale dans le bruit des 26/08 et 15/09/2021

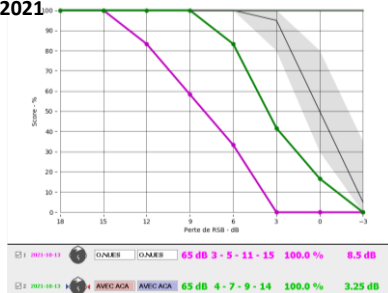

Conditions du test

- Test VRB
- Oreilles Nues
- Avec appareils

Verso libre pour l'audioprothésiste

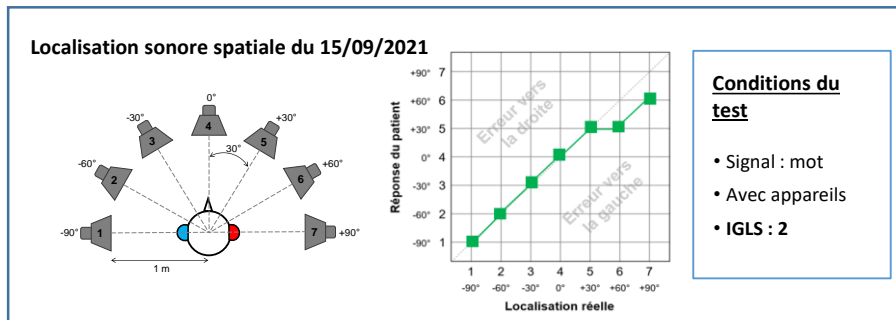

Questionnaire COSI du 24/09/2021

Date: Besoins déterminés

Date: Résultat évalué Septembre 24, 2021

| Changement observé Grâce au nouvel appareil, j'entends maintenant... | Aptitude finale J'entends distinctement... | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 100% (presque jamais) | 25% (à l'occasion) | 50% (moitié du temps) | 75% (plus que du temps) | 95% (presque toujours) |
| Meurs bien | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Peu de différence | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Légèrement mieux | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mieux | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Beaucoup mieux | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notes: J'AI ENCORE EN COURS D'UTILISER LE STEREO POUR LA TELEVISION

espace libre pour l'audioprothésiste

Acouphénométrie du 28/08/2021

- Test au casque en binaural
- Type de bruit : Son pur
- Fréquence : 3.120 Hz
- Intensité équivalente : 4 dB
- Niveau Masque Minimum : 11 dB
- Inhibition résiduelle : 39 secondes

